




Jornades d'esterilització

20 i 21 d'octubre 2022

Compartint diferents realidades en las RUMED

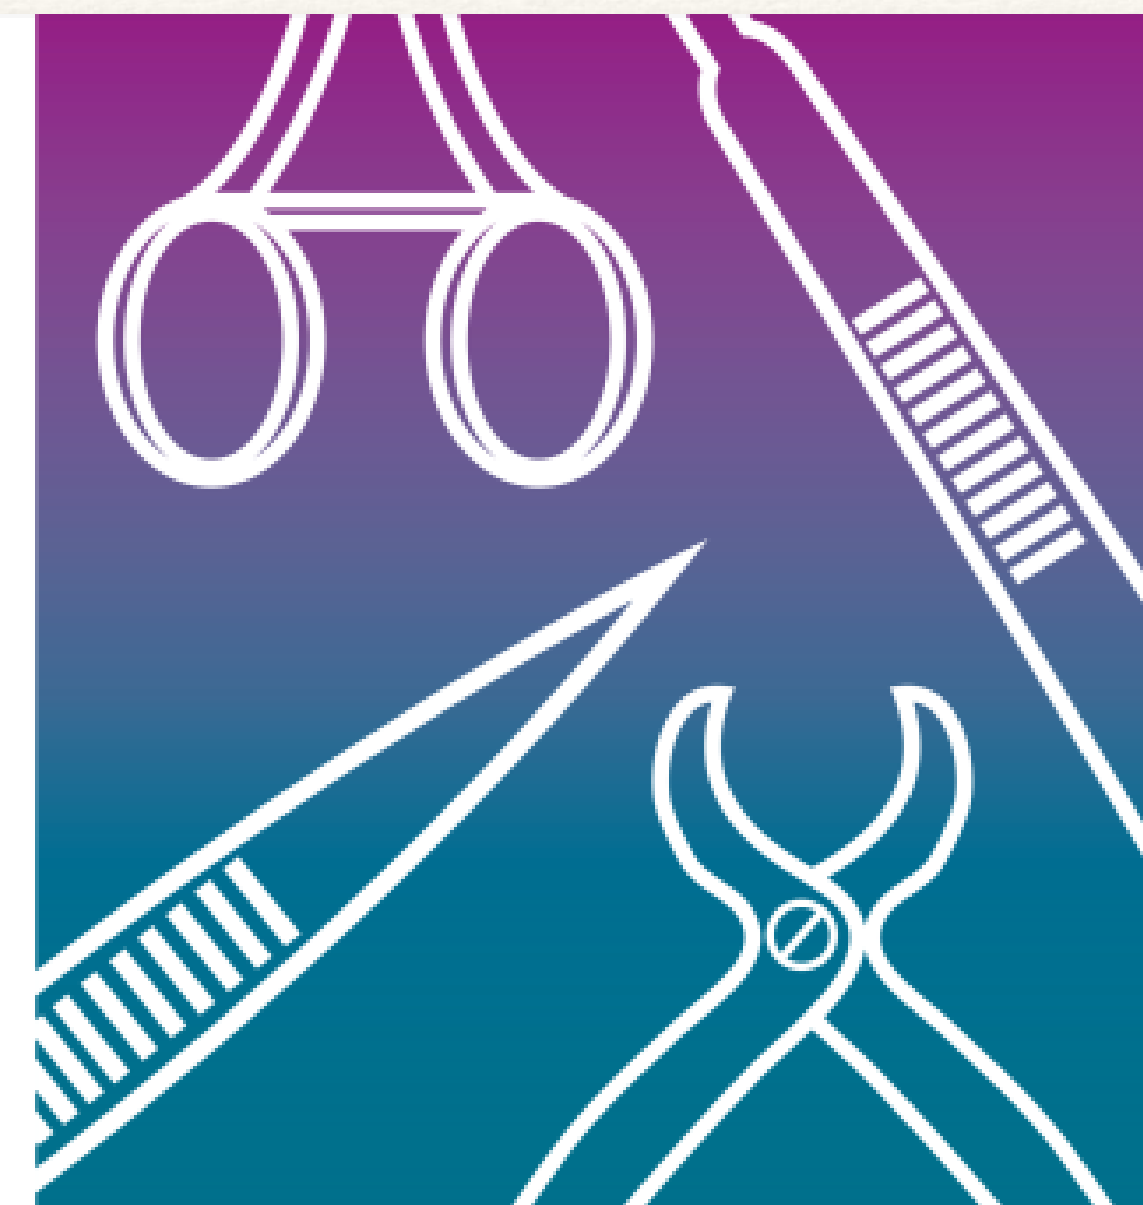

EL REPROCESAMIENTO DEL MATERIAL EN ATENCIÓN PRIMARIA: OTRA RUMED

DOLORS ROYUELA
SUPERVISORA RUMED
HOSPITAL UNIVERSITARI BELLVITGE

Gerencia Territorial Metropolitana Sur

- Hospital Universitari de Bellvitge (HUB)
- Hospital de Viladecans
- Direcció de Atenció Primària (DAP) Costa de Ponent





Hospital Innovador

Mas de 5000 professionals

Màxima complexidad

2 millones de personas

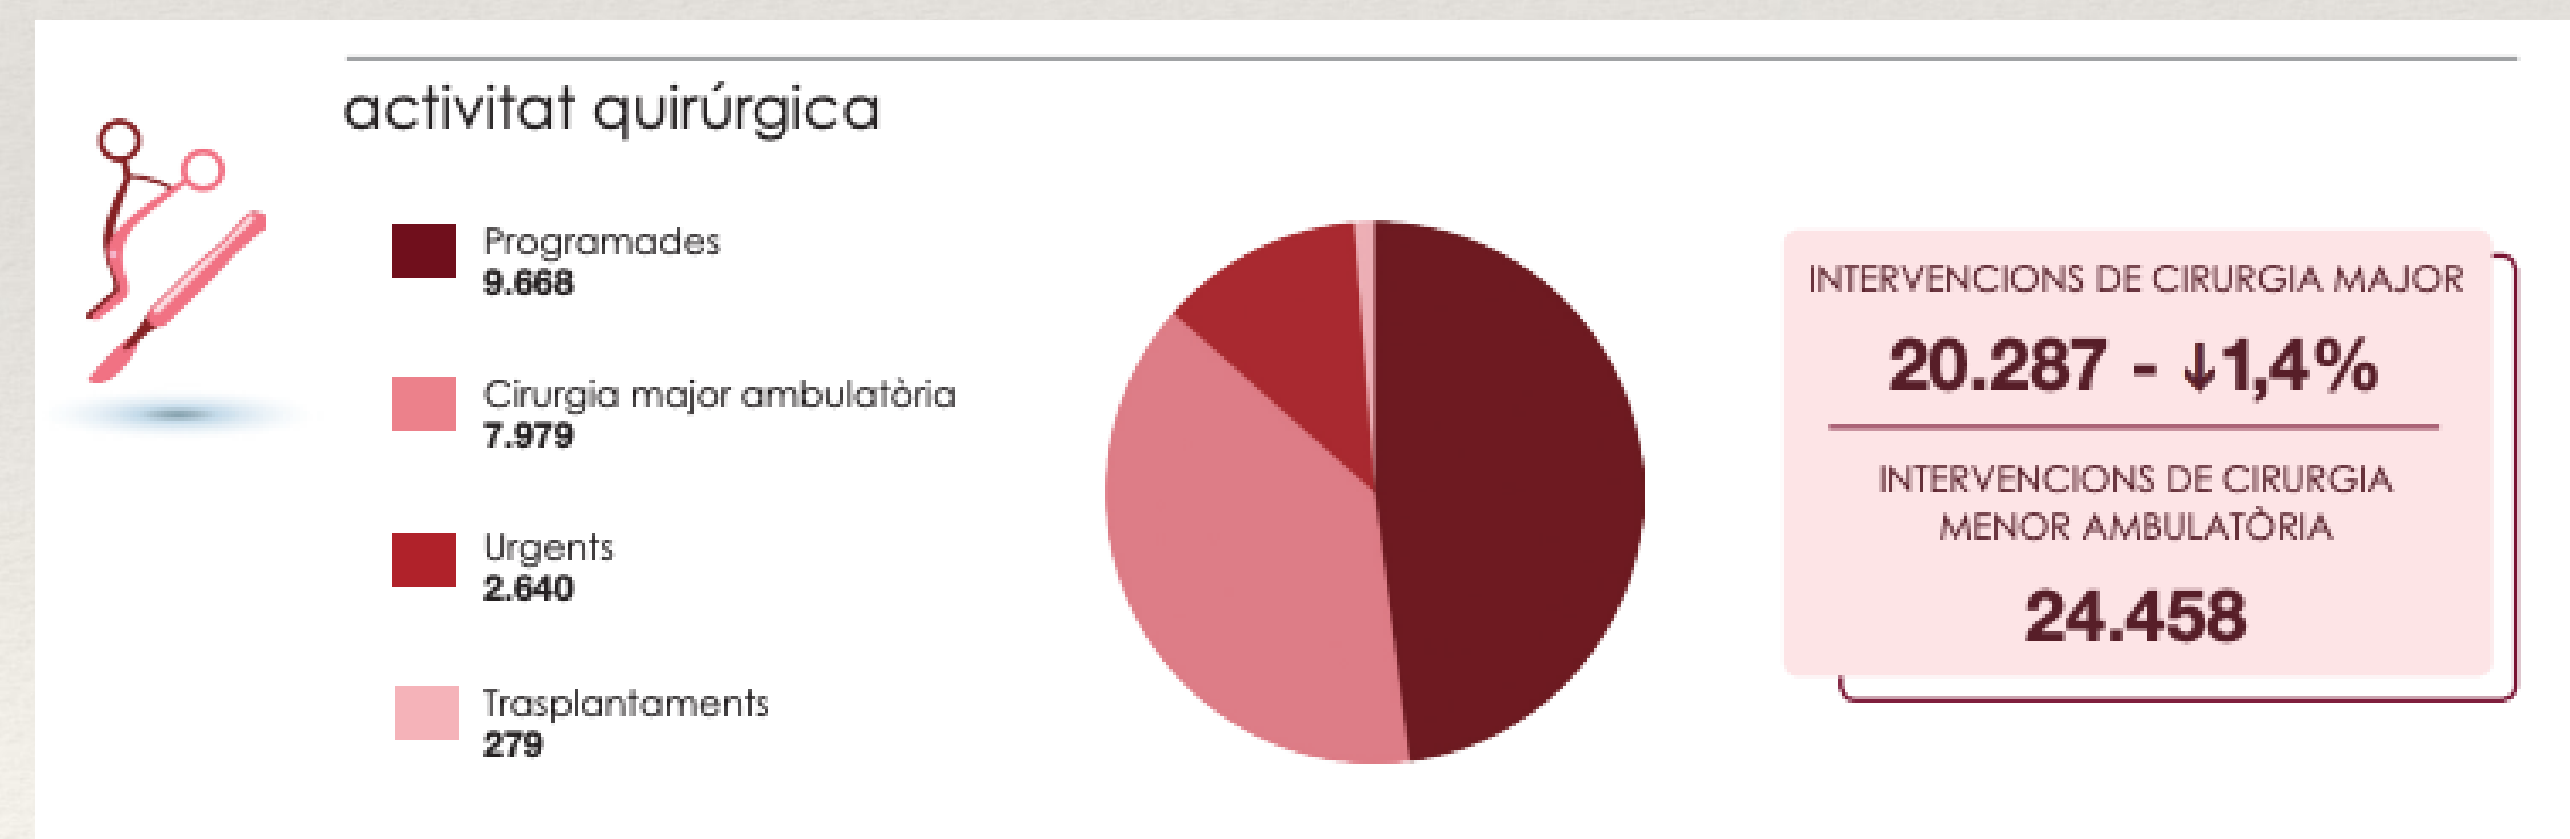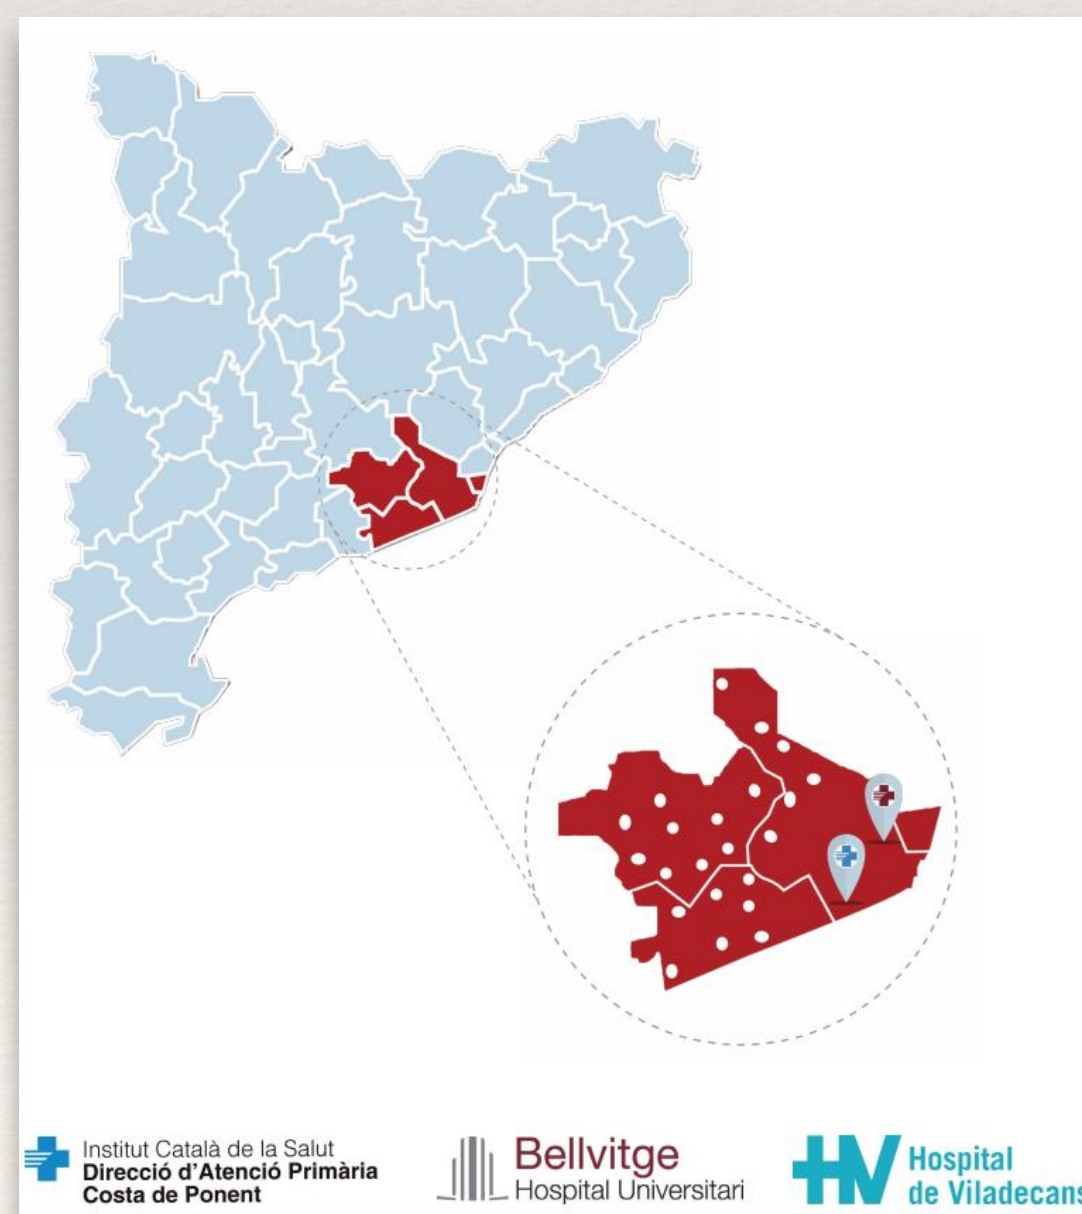

UCEST (Unitat Central d'Esterilització)

- Inaugurada en septiembre de 2019
- Una superficie de 1000m²
- Certificada en ISO 9001:2015
- Equipamiento de última generación





Tres áreas funcionales independientes:

1. Área de lavado
2. Área de preparación y esterilización
3. Área estéril




La UCEST garantiza un producto final con trazabilidad, reprocesamiento integral y un alto estándar de calidad.

33 QUIRÓFANOS

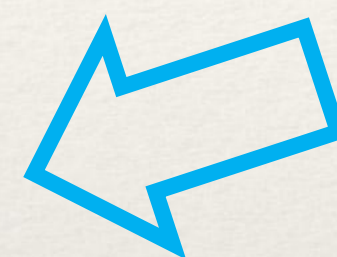


101 CENTROS ATENCIÓN PRIMARIA

C. EXTERNES
GABINETS
AMBULATORIS,
HOSPITALITZACIÓ
SERVEI
URGÈNCIES,
UNITATS CRÍTICS,
EDIFICI DELTA

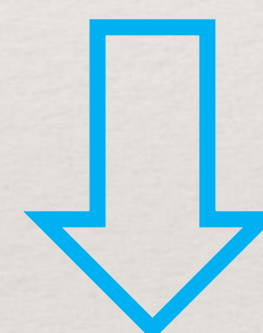

Dirección de Atención Primaria (DAP) Costa de Ponent

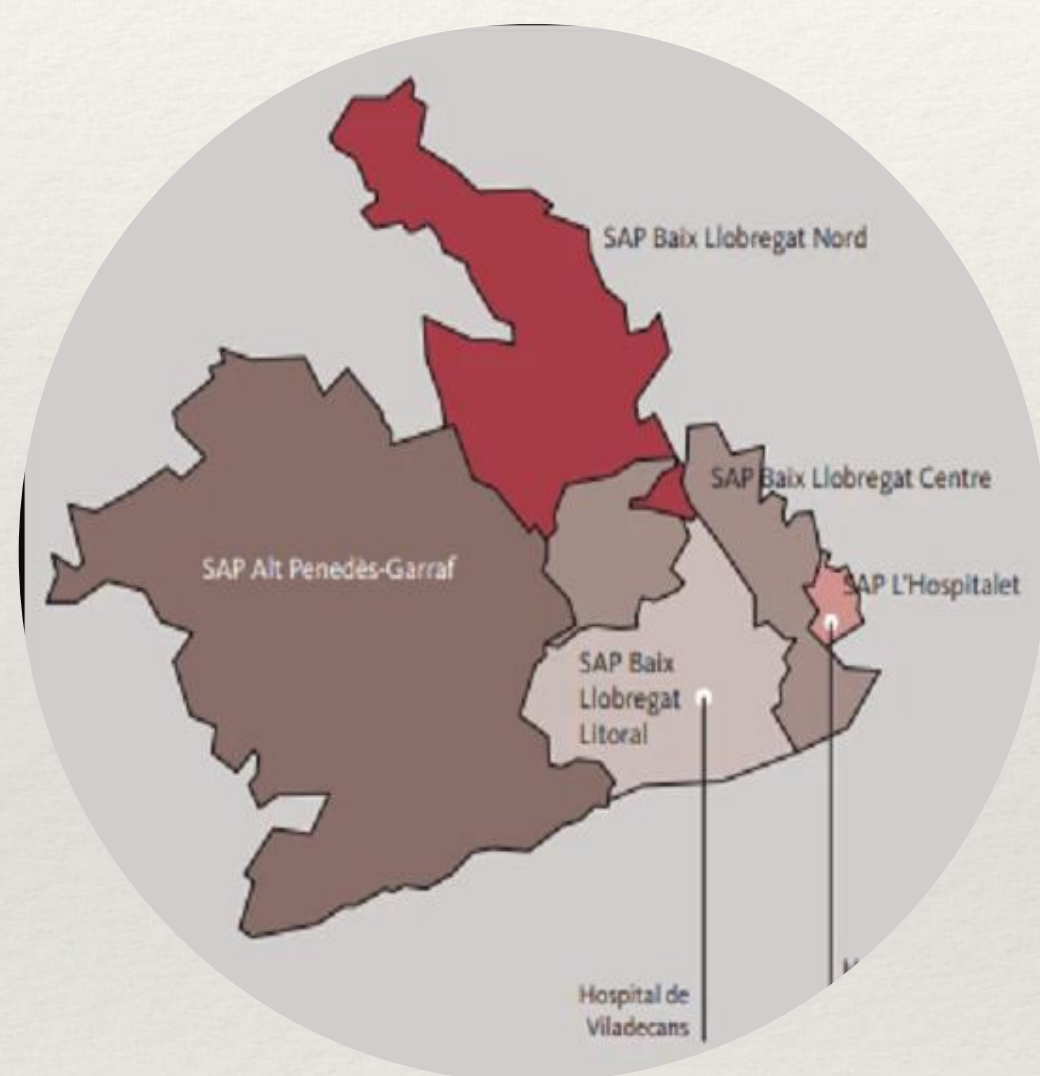

SAP Baix Llobregat Nord

19 Centros



SAP Baix Llobregat Centre

38 Centros



SAP Baix Llobregat Litoral
y SAP L'Hospitalet

44 Centros



*SAP Penedés- Garraf es independiente de la UCEST del HUB

Instrucciones de preparación del material para esterilizar

- Material limpio y bien seco.
- En una única bolsa de plástico y sin embolsado individual.

PROCEDIMENT	DATA	CODIFICACIÓ
Circuit d'entrega i recollida de material per esterilitzar dels equips a l'HUB	01-07-2021	G108E1CIR01
OBJECTE Descriure el circuit a seguir per transportar el material a esterilitzar dels equips d'Atenció Primària i dels serveis d'odontologia, de les unitats de suport (ASSIR, QUAP i P4C) del SAP Baix Llobregat Centre, SAP Delta i la zona Nord del SAP APG, Baix Llobregat Nord, a la Central d'Esterilització de l'HUB (UCEST); així com la tornada i lliurament del material als centres.		
ENTRADES * Necessitat d'esterilitzar el material sanitari dels EAP i altres UP, a la UCEST de l'HUB.		
ACTIVITATS		
EAP i UP	Servei de valisa	SAP
Necessitat d'esterilitzar el material sanitari dels EAP i altres UP, a la UCEST de l'HUB.		
Preparació contenidors → Omple petició material i posa al contenidor (Valisa sortida) → Traslada contenidors a la UCEST de l'HUB		
Preparació turbinas (24h) → Omple petició i emborsa (sol·licita valisa especial) → Traslada contenidors als SAP (Etiqueta Urgents) → Esterilització i control del procés UCEST HUB		
Traslada contenidors als centres (EAP i UP) → Material esterilitzat → Emmagatzematge protegit i preservat del material esterilitzat		
RESULTATS * Material esterilitzat, enviat als equips i/o unitats productives. * Emmagatzematge protegit i preservat.		

CODIFICACIÓ
21 G108E1CIR01

la petició, l'introdueix al contenidor de preparació de jorxades al contenidor.

si turbinas a la UCEST

d'entrades i sortides, urbines que envia.

ti les turbinas al punt ata com Urgents. intralitzat.

IE L'HUB

stiqueta enganxada a la

tenidors, del material a

animent de JB.

, i el retorn si d'Atenció

ocediments establerts i

AP i UP)

UCEST de l'HUB i els

5. EMMAGATZEMATGE DEL MATERIAL I DELS SETS ESTERILITZATS ALS CENTRES

El personal dels EAP i de les UP encarregats de recollir els contenidors que arriben de la UCEST de l'HUB i d'emmagatzemar el material, apliquen els procediments interns dels centres. Per garantir la seguretat, és important respectar la data de caducitat del paquet del material esterilitzat i guardar-lo en llocs preservats d'agents que els puguin deteriorar i/o malmetre.

INFORMACIÓ DOCUMENTADA DE REFERÈNCIA

- Normativa d'esterilització de la UCEST de l'HUB
 - IMP 09-1/7 Petició d'esterilització de material sanitari- Full d'entrades i sortides.
 - Instruccions de preparació de material a esterilitzar.
 - Albarà- Full de petició/ sol·licitud de servei- IMP 09-1/7 Petició d'esterilització de material sanitari- Full d'entrades i sortides
 - Bosses especials per al material de 24h.
- EPI:
- No són necessaris.

Procediment a seguir per la persona responsable de preparar i d'enviar el material a la UCEST de l'HUB:

- Omple l'albarà IMP 09-1/7 Petició d'esterilització de material sanitari- Full d'entrades i sortides, amb les dades del centre, la data i la signatura. Especifica quin material i quina quantitat de peces envia.



- El material punzante poner a parte para evitar accidentes (contenedor pequeño)
- Material pequeño (fresas, puntas...) colocar en un recipiente pequeño y cerrado para evitar que se pierdan (bote con tapa de rosca).

Instrucciones de preparación del material para esterilizar

➤ Diferenciar el material por sistema de esterilización

Pedido de material

Datos de cabecera


Método: Seleccione...
VAPOR - CONTENIDOR 134°
PLASMA - STANDARD
VAPOR - INST/TEXTIL 134°

Extensión telefónica

Método 🔍



➤ **Material de diferentes especialidades**, se separa en diferentes bolsas de plástico, identificando cada bolsa con su número de albaran.

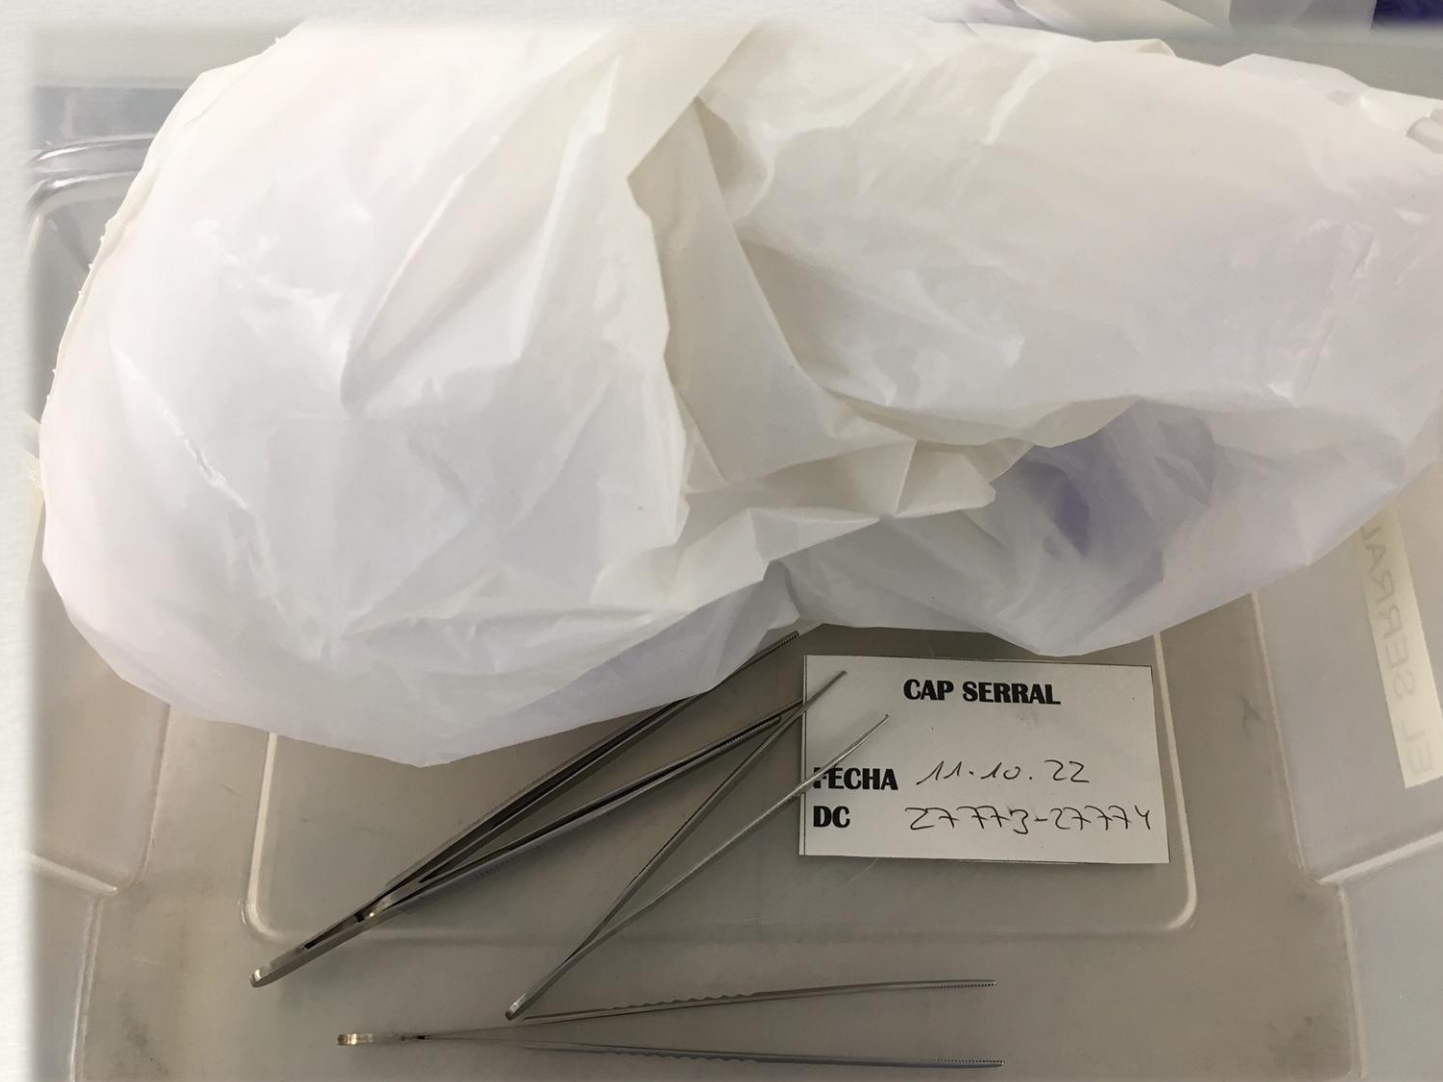

Instrucciones de preparación del material para esterilizar

- Hacer uso de uno o mas contenedores de transporte segun la cantidad de piezas que se hayan de procesar .
Maximo 50 piezas (pequeñas) por contenedor ya que despues del empaquetado y esterilizacion aumenta el volumen de las piezas



Solicitud

Institut Català de la Salut
Atenció Primària
Metropolitana Sud

Usuari:
Contrasenya:

Institut Català de la Salut | CatSalut | ATRI | Portal ICS | Recull Premsa | Informació SAP | Intranets SAP
18:43 h | Dimecres, 12 de octubre del 2022 | 2.663.535 visites | 46 Usuaris on-line | Connectat des de: 10.84.50.5

uneix
Transformant l'Atenció Primària a Metrosud

Diligència de la convocatòria de dos/dues tècnics/ques de compres per la Unitat de Compres i Logística de l'Hospital Universitari de Bellvitge
Diligència d'ampliació del termini de sol·licituds de la convocatòria (Ref. HUB 22/2022), per la selecció de dos/dues tècnics/ques de compres per la Unitat de Compres i Logística de l'Hospital Universitari de Bellvitge.
• [Veure la diligència](#)

Diligència de la convocatòria d'un Cap de la Unitat de Compres i Logística de l'Hospital de Bellvitge
Diligència de la llista definitiva de persones admeses/excloses a la convocatòria d'un Cap de la Unitat de Compres i Logística de l'Hospital Universitari de Bellvitge (Ref. Hub. 21/2022).
• [Veure la diligència](#)

Diligència de la convocatòria de la categoria de tècnic/a especialista de grau superior sanitari en imatge per al diagnòstic (TDPI LLIURE-2019)
Diligència del tribunal qualificador de la convocatòria específica del provés selectiu per proveir places de la categoria de tècnic/a especialista de grau superior sanitari en imatge per al diagnòstic (TDPI LLIURE-2019) que dona publicitat als resultats definitius del concurs de mèrits, les puntuacions finals del concurs oposició i l'ordre final de classificació assolit per cada persona aspirant.
• [Veure la diligència](#)

Convocatòria del Director/a de l'EAP de pediatria Territorial de l'Alt Penedès
Convocatòria per a l'assignació de funcions del Director/a de l'Equip d'Atenció Primària de Pediatria Territorial de l'Alt Penedès. El termini de presentació de sol·licituds és del 7 al 26 d'octubre de 2022, ambdós inclosos.
• [Veure la convocatòria](#)

Diligència convocatòria de tres tècnics/ques superiors de prevenció de riscos laborals de les Unitats Bàsiques de

Convocatòria de dos/dues tècnics/ques de compres per la Unitat de Compres i Logística de l'Hospital Universitari de Bellvitge (Ref. HUB 22/2022)
Publicació de la convocatòria de dos/dues tècnics/ques de compres per la Unitat de Compres i Logística de l'Hospital Universitari de Bellvitge (Ref. HUB 22/2022). El termini de presentació de sol·licituds és del 4 al 18 d'octubre de 2022, ambdós inclosos.
• [Veure la convocatòria](#)

Resolució d'adjudicació de places de la categoria diplomada/da sanitari/ària en fisioteràpia (FISIO LLIURE-2018)
Resolució SLT/2816/2022, de 20 de setembre, d'adjudicació de places de la categoria diplomada/da sanitari/ària en fisioteràpia pel sistema de concurs oposició (Convocatòria FISIO LLIURE-2018).
• [Veure la resolució](#)

Resolució d'adjudicació de les places corresponents a la categoria d'auxiliar d'hoteleria (AUX HOT.LLIURE-2019)
Resolució SLT/2857/2022, de 22 de setembre, d'adjudicació de

DIRECTORI INTRANET
CERCADOR INTRANET
ESPAIS COL·LABORACIÓ ATENCIÓ PRIMÀRIA
ECAP ADMINISTRATIU
NOVETATS ECAP i ECAPAdmin
Vigilància Epidemiològica
ATENCIÓ CRÒNICS
PosTIC
ECAP blog
Eutanàsia Professionals
Comitè d'Ètica Assistencial en Atenció Primària

BO ICS
Quadre comandament DAP
Quadern de comandament ICS
SISAP Longview
SISAP- UMI
MSIQ_CatSalut
Consumibles informàtica
Pos-TIC
TRAZINS
SNISP Cat



Seleccione unidad / servicio

Centro

TRAZINS GESTIÓN Y TRAZABILIDAD DEL INSTRUMENTAL QUIRÚRGICO

Centro

Unidad / Servicio

Pedido de material

Datos de cabecera

Método Extensión telefónica Observaciones

Materiales

Especialidad	Descripción	Método	Cantidad

Imagen del material

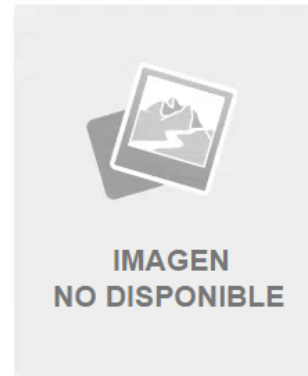


IMAGEN NO DISPONIBLE


Total: 0

Solicitud

Listado de material genérico

Especialidad	Descripción	Método
<input type="checkbox"/>	PRIMARIA MANGO AUTOMATRIX	VAPOR - INST/TEXTIL 134°
<input type="checkbox"/>	PRIMARIA DILATADOR LAGRIMAL	VAPOR - INST/TEXTIL 134°
<input type="checkbox"/>	PRIMARIA ARCO DE YOUNG	VAPOR - INST/TEXTIL 134°
<input type="checkbox"/>	PRIMARIA PORTA CLAMPS	VAPOR - INST/TEXTIL 134°
<input type="checkbox"/>	PRIMARIA SET DE CURES (4 PECES)	VAPOR - INST/TEXTIL 134°
<input checked="" type="checkbox"/>	PRIMARIA PINÇA HUNTER	VAPOR - INST/TEXTIL 134°
<input checked="" type="checkbox"/>	PRIMARIA PINÇA COLLIN	VAPOR - INST/TEXTIL 134°
<input type="checkbox"/>	PRIMARIA PINÇA COCODRILO	VAPOR - INST/TEXTIL 134°
<input type="checkbox"/>	PRIMARIA SEPARADOR SEM ROMO	VAPOR - INST/TEXTIL 134°
<input type="checkbox"/>	PRIMARIA MANEC ODONTO	VAPOR - INST/TEXTIL 134°
<input type="checkbox"/>	PRIMARIA LLAVE PUNTA CAVITRON	VAPOR - INST/TEXTIL 134°
<input type="checkbox"/>	PRIMARIA CERRA DISSECCIO	VAPOR - INST/TEXTIL 134°

Imagen del material



TRAZINS GESTIÓN Y TRAZABILIDAD DEL INSTRUMENTAL QUIRÚRGICO

Pedido de material

Estado del pedido

Inventario

Centro: Hospital Universitari Bellvitge

Unidad / Servicio: EXTC CONSULTORI CERVELLO

H501UDRM

SOPORTE TRAZINS

CAMBIAR ORIGEN

CERRAR SESIÓN

Pedido de material

Datos de cabecera

Método: VAPOR - INST/TEXTIL 134°

Extensión telefónica:

Observaciones:

Materiales

Especialidad	Descripción	Método	Cantidad
<input type="checkbox"/>	PRIMARIA PINCES DISSECCIO A/D	VAPOR - INST/TEXTIL 134°	1
<input type="checkbox"/>	PRIMARIA PINCES DISSECCIO S/D	VAPOR - INST/TEXTIL 134°	2
<input checked="" type="checkbox"/>	PRIMARIA PINCES ADSON S/D	VAPOR - INST/TEXTIL 134°	1
<input type="checkbox"/>	PRIMARIA PINCES BAYONETA LUCAE	VAPOR - INST/TEXTIL 134°	1
<input type="checkbox"/>	PRIMARIA PINCES KOCHER S/D	VAPOR - INST/TEXTIL 134°	2
<input type="checkbox"/>	PRIMARIA PINCES MAGILL	VAPOR - INST/TEXTIL 134°	1
<input type="checkbox"/>	PRIMARIA PINCES TREURE GRAPES	VAPOR - INST/TEXTIL 134°	1

Total: 9

+ AÑADIR ELIMINAR

CREAR PEDIDO

Imagen del material



La seva comanda s'ha creat correctament amb el codi d'albarà: DC-88

Acceptar



Recepción en la UCEST



Durante la mañana, en diferentes horarios:

- SAP Norte
- SAP Delta
- SAP Centro




Desinfección del contenedor
antes de manipularlo

Recepción en la UCEST

Entrada 27737: Pendiente de recepción

Datos de Entrada

Destino: (HUB) Hospital Universitari Bellvitge Zona de origen: EXTD CAP 17 SETEMBRE ODONTO Limpieza:

Creación: 13728090B 11/10/2022 13:29 Carro para envío:  Incidencias:

Envío: 13728090B 11/10/2022 13:29 Número de albarán: DC-27737 Cantidad:

Recepción: Urgente Calidad:

Observaciones:

Cajas

Descripción	Teórico	Ubicación




Artículos sueltos

Código	Descripción



Genéricos

Código	Descripción	Cant.	Rec.
	CURETA ORL	3	3
	BOTADOR	3	3
	FORCEPS ODONTOLOGIA	3	3
	MIRALL ODONTOLOGIA	6	6
	RASPALL POLIR	1	1
	XERINGUES DENTALS	3	3

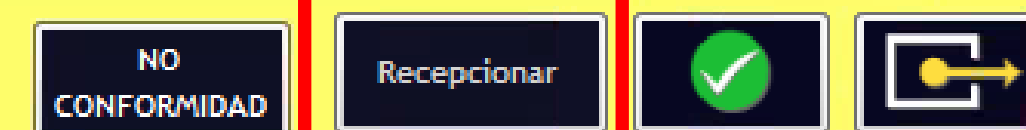

Recepción en la UCEST

Entrada 27323: Pendiente de validación

Datos de Entrada

Destino:	(HUB) Hospital Universitari Bellvitge	Zona de origen:	EXTC EAP SANT ILDEFONS CORNELL	Limpieza:	
Creación:	48164786A 10/10/2022 11:49	Carro para envío:		Incidencias:	
Envío:	48164786A 10/10/2022 11:49	Número de albarán:	DC-27323	Cantidad:	
Recepción:	47517304v 11/10/2022 12:35			Calidad:	

Urgente

Observaciones: dividido en un contenedor

Cajas

Descripción	Teórico	Ubicación

Artículos sueltos

Código	Descripción

Genéricos

Código	Descripción	Cant.	Rec.
	PINCES MOSQUIT S/D	23	23
	PINCES PORTA AGULLES	4	4
	MANEC BISTURI	11	11

NO CONFORMIDAD



Recepción en la UCEST



Pedido de material

Estado del pedido

Inventario

Centro

Hospital Universitari Bellvitge

Unidad / Servicio

EXTC CONSULTORI CERVELLO

H501UDRM

SOPORTE TRAZINS

CAMBIAR ORIGEN

CERRAR SESIÓN

Estado del pedido

Datos de cabecera

Fecha

03/10/2022 - 19/10/2022

Código de albarán

BUSCAR

Pedidos

Código de albarán	Fecha de creación	Estado	Observaciones
DC-29877	19/10/2022	Creado	
DC-29383	18/10/2022	Recibido	
DC-29022	17/10/2022	Devuelto	
DC-29017	17/10/2022	Devuelto	
DC-28562	14/10/2022	Devuelto	
DC-27775	11/10/2022	Devuelto	
DC-27364	10/10/2022	Devuelto	
DC-26954	07/10/2022	Devuelto	
DC-26560	06/10/2022	Devuelto	
DC-26171	05/10/2022	Devuelto	
DC-25597	04/10/2022	Devuelto	

Preparación en UCEST



Preparación en UCEST



Revisión, embolsado y etiquetado de material

Preparación en UCEST



Termosellado del embalaje del material y revisión del control químico interno.

Preparación en UCEST




Carga del material en el autoclave

Preparación en UCEST

Revisión y liberación (lectura control biológico) del material después de la esterilización y preparación del contenedor para entregar al cliente.



Recepción del material estéril en el centro de primaria

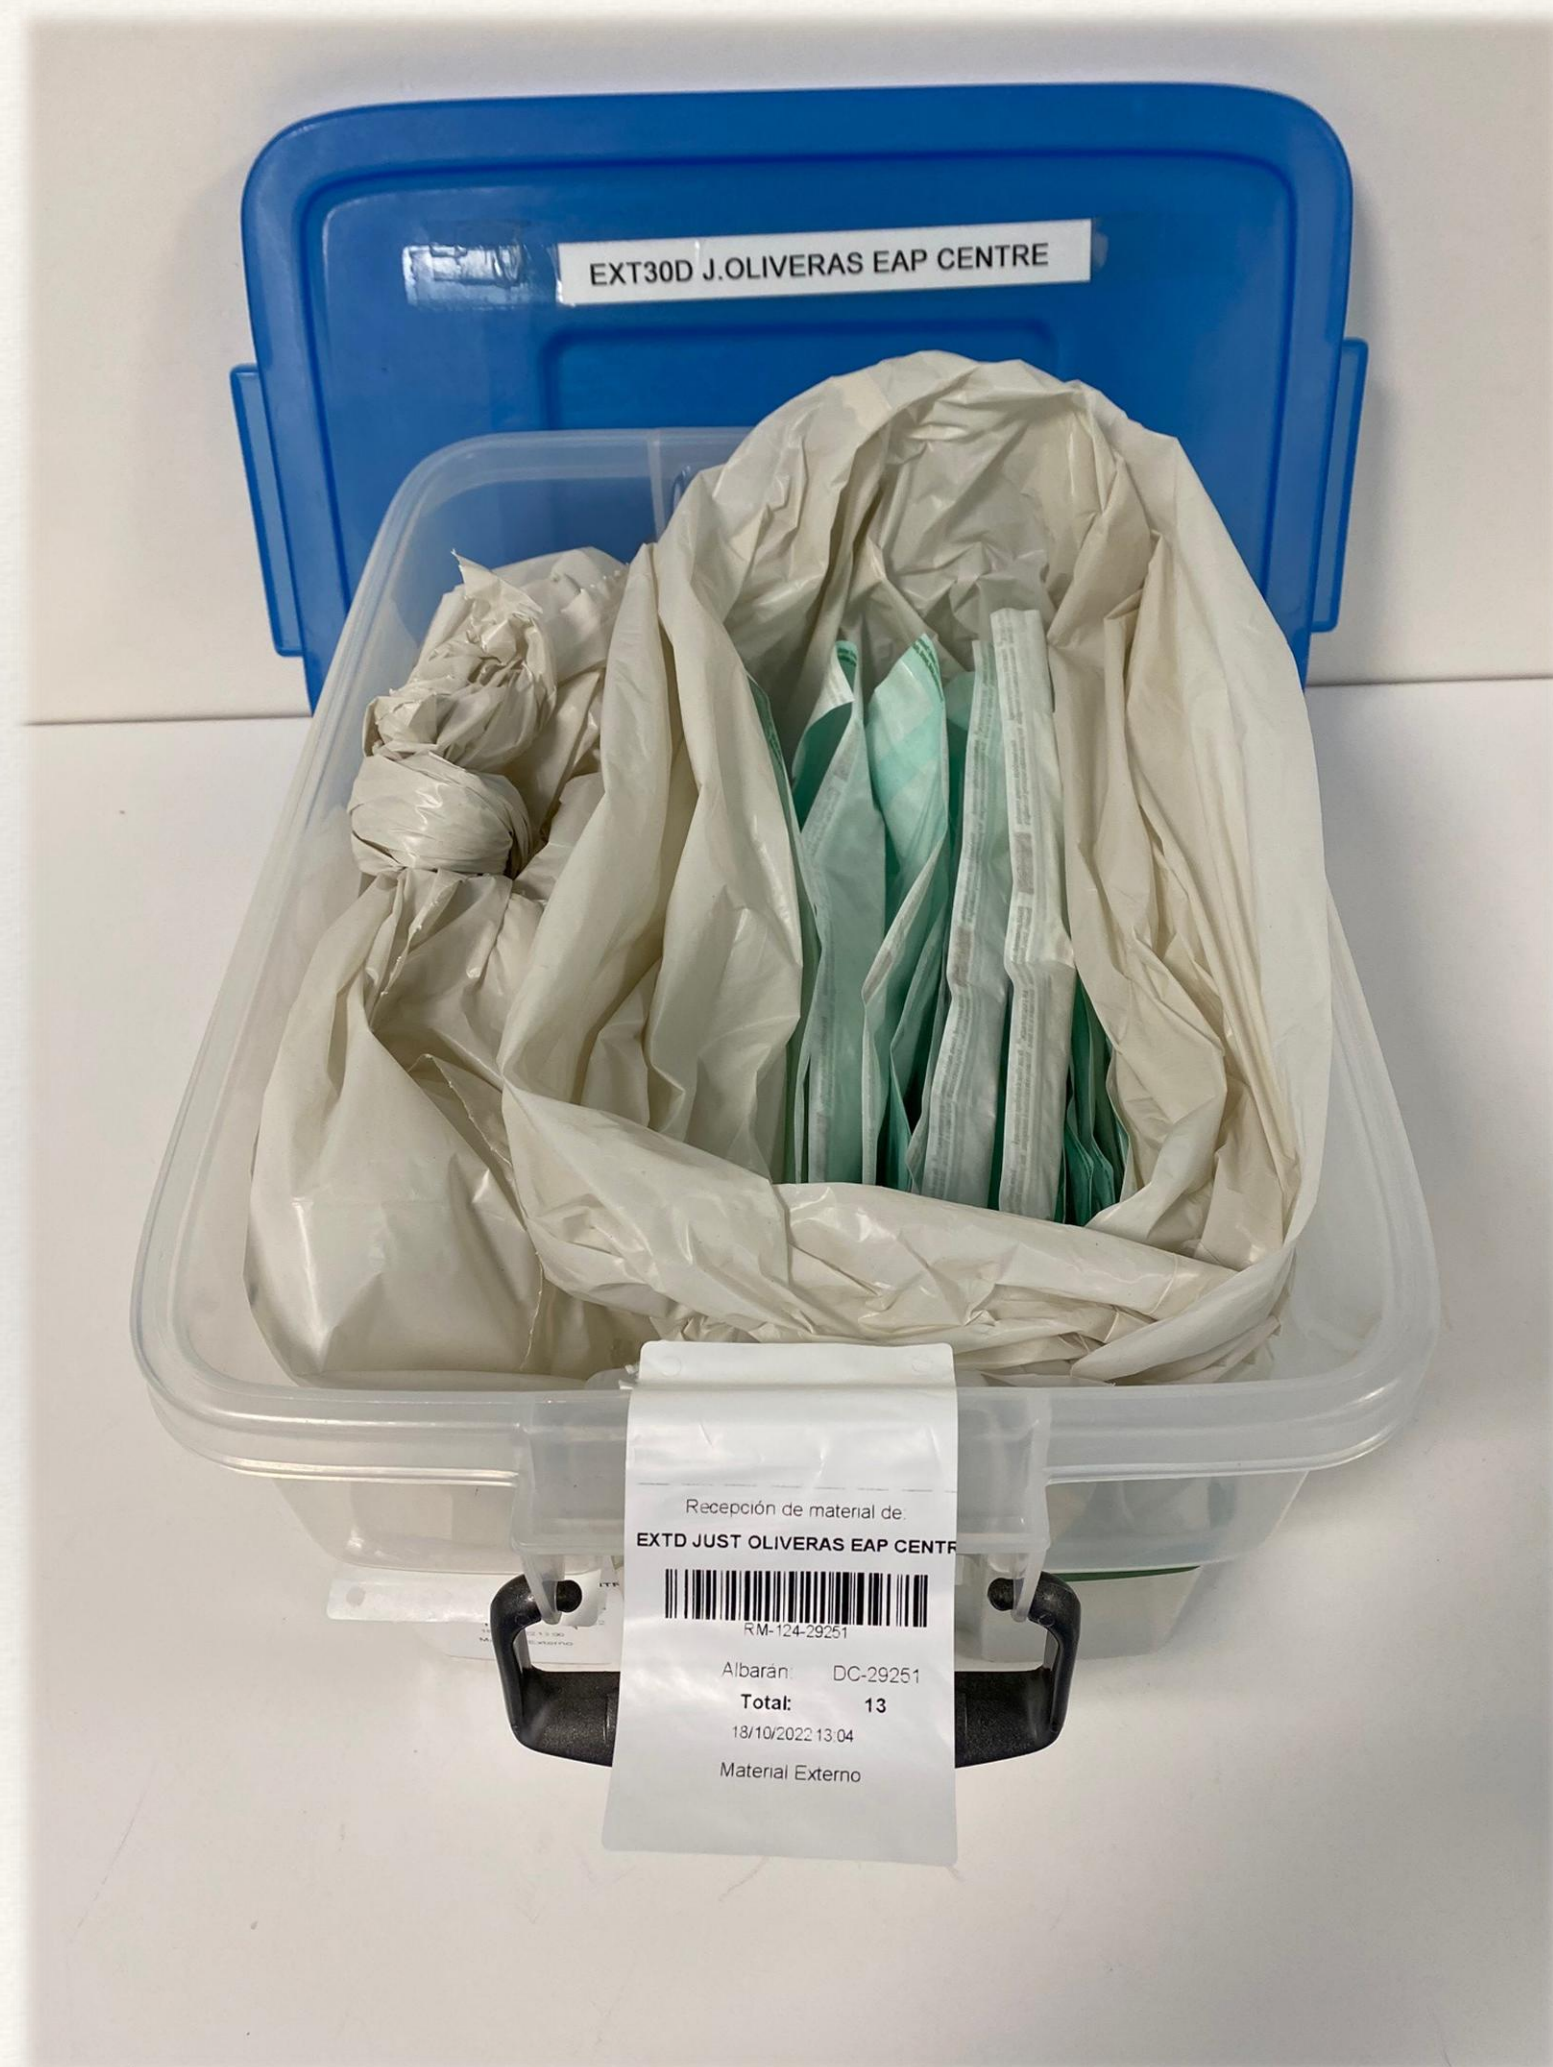

- ✓ Comprobación de que el material devuelto es el correcto (origen y cantidad)
- ✓ Revisión de la integridad del envoltorio
- ✓ Revisión de los controles químicos interno y externo

Trazabilidad y Seguimiento del pedido



GESTIÓN Y TRAZABILIDAD DEL INSTRUMENTAL QUIRÚRGICO

Pedido de material

Estado del pedido

Inventario

Centro

Hospital Universitari Bellvitge

Unidad / Servicio

EXTN EAP MARTORELL URBA

H501UDRM

SOPORTE TRAZINS

CAMBIAR ORIGEN

CERRAR SESIÓN

Estado del pedido

Datos de cabecera

Fecha

17/10/2022 - 19/10/2022

Código de albarán

BUSCAR

Pedidos

Código de albarán	Fecha de creación	Estado	Observaciones
DC-29383	18/10/2022	● Recibido	
DC-29022	17/10/2022	● Devuelto	
DC-29017	17/10/2022	● Devuelto	

Trazabilidad y Seguimiento del pedido

Listado de material genérico


Descripción	Id	Estado	Incidencia	Id Incidencia
+ BOTADOR(7)		● Aceptado		
+ XERINGUES DENTALS(5)		● Aceptado		
+ FORCEPS ODONTOLOGIA(7)		● Aceptado		
+ PINCES MERIAN(3)		● Aceptado		
+ MIRALL ODONTOLOGIA(4)		● Aceptado		
+ SONDES EXPLORACIÓ(3)		● Aceptado		
+ CURETES HEMINGWAY(7)		● Aceptado		
+ PINCES DISSECCIO A/D(2)		● Aceptado		
+ PINCES DISSECCIO S/D(6)		● Aceptado		

Listado de material genérico

Descripción	Id	Estado	Incidencia	Id Incidencia
+ BOTADOR(7)		● Aceptado		
- XERINGUES DENTALS(5)		● Aceptado		
XERINGUES DENTALS	110112E2022101800795	● Aceptado		
XERINGUES DENTALS	110112E2022101800796	● Aceptado		
XERINGUES DENTALS	110112E2022101800797	● Aceptado		
XERINGUES DENTALS	110112E2022101800798	● Aceptado		
XERINGUES DENTALS	110112E2022101800799	● Aceptado		
+ FORCEPS ODONTOLOGIA(7)		● Aceptado		
+ PINCES MERIAN(3)		● Aceptado		
+ MIRALL ODONTOLOGIA(4)		● Aceptado		
+ SONDES EXPLORACIÓ(3)		● Aceptado		
+ CURETES HEMINGWAY(7)		● Aceptado		
+ PINCES DISSECCIO A/D(2)		● Aceptado		


Resultados productividad

PRODUCTIVIDAD

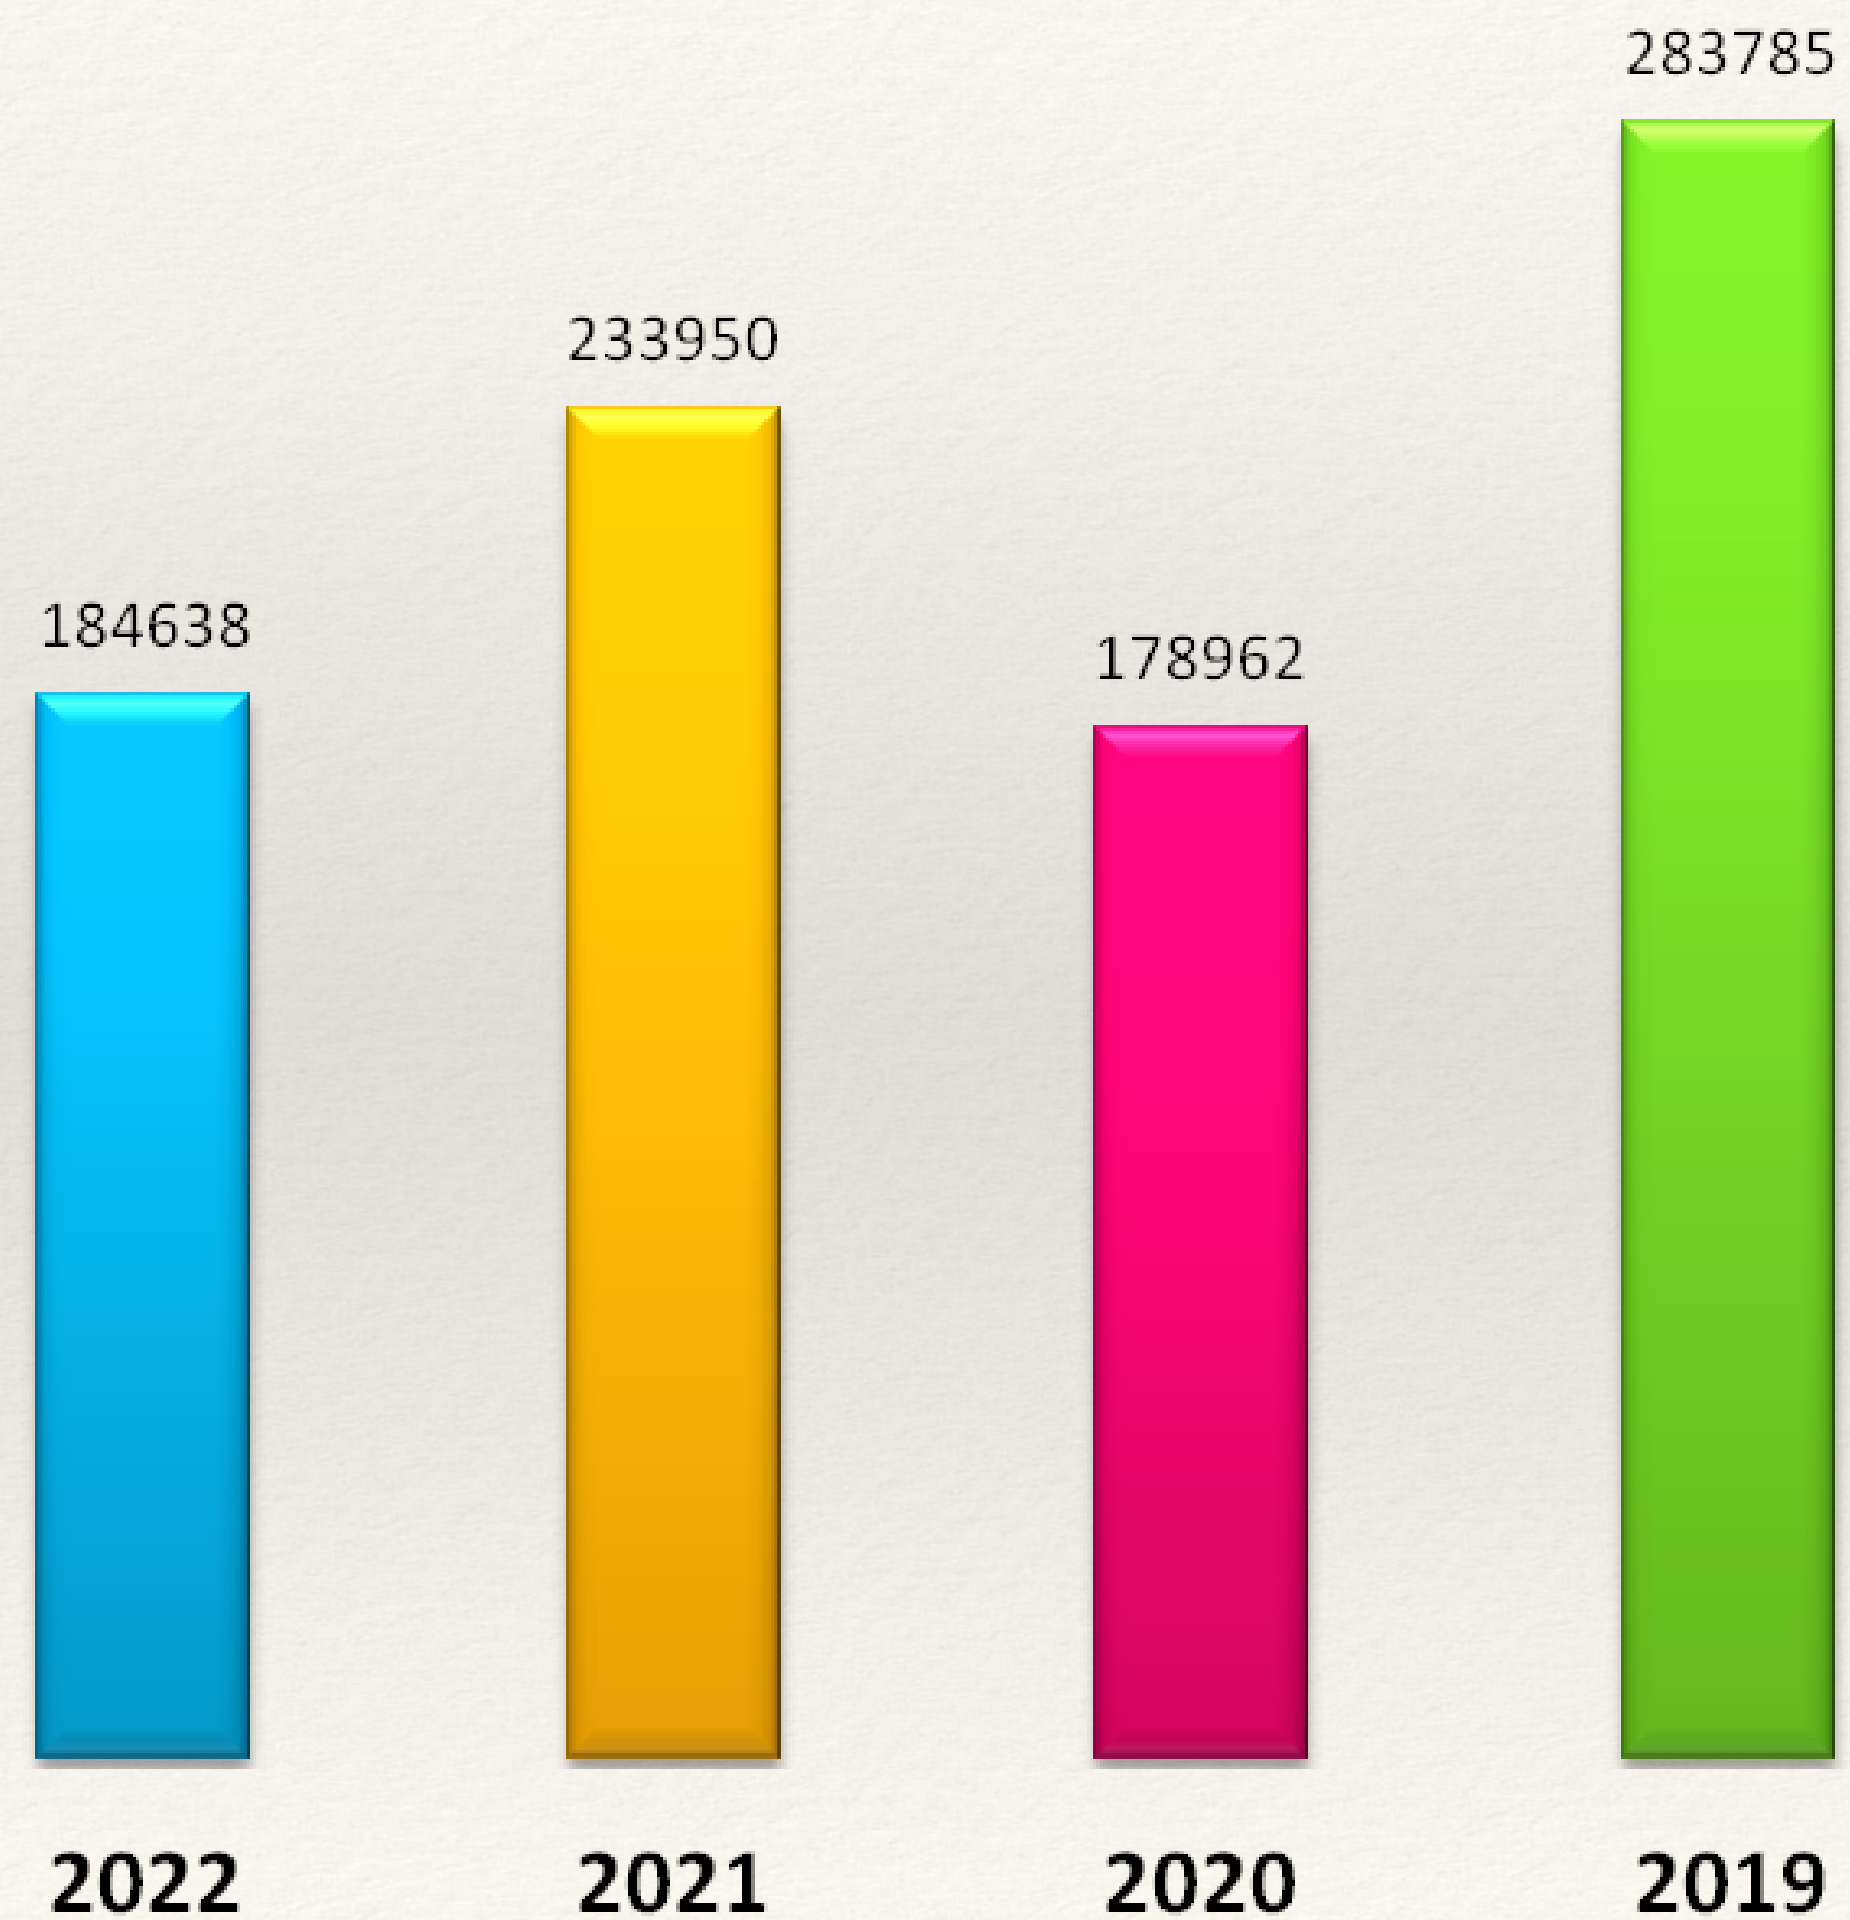


Incidencias y NC


NO CONFORMIDADES

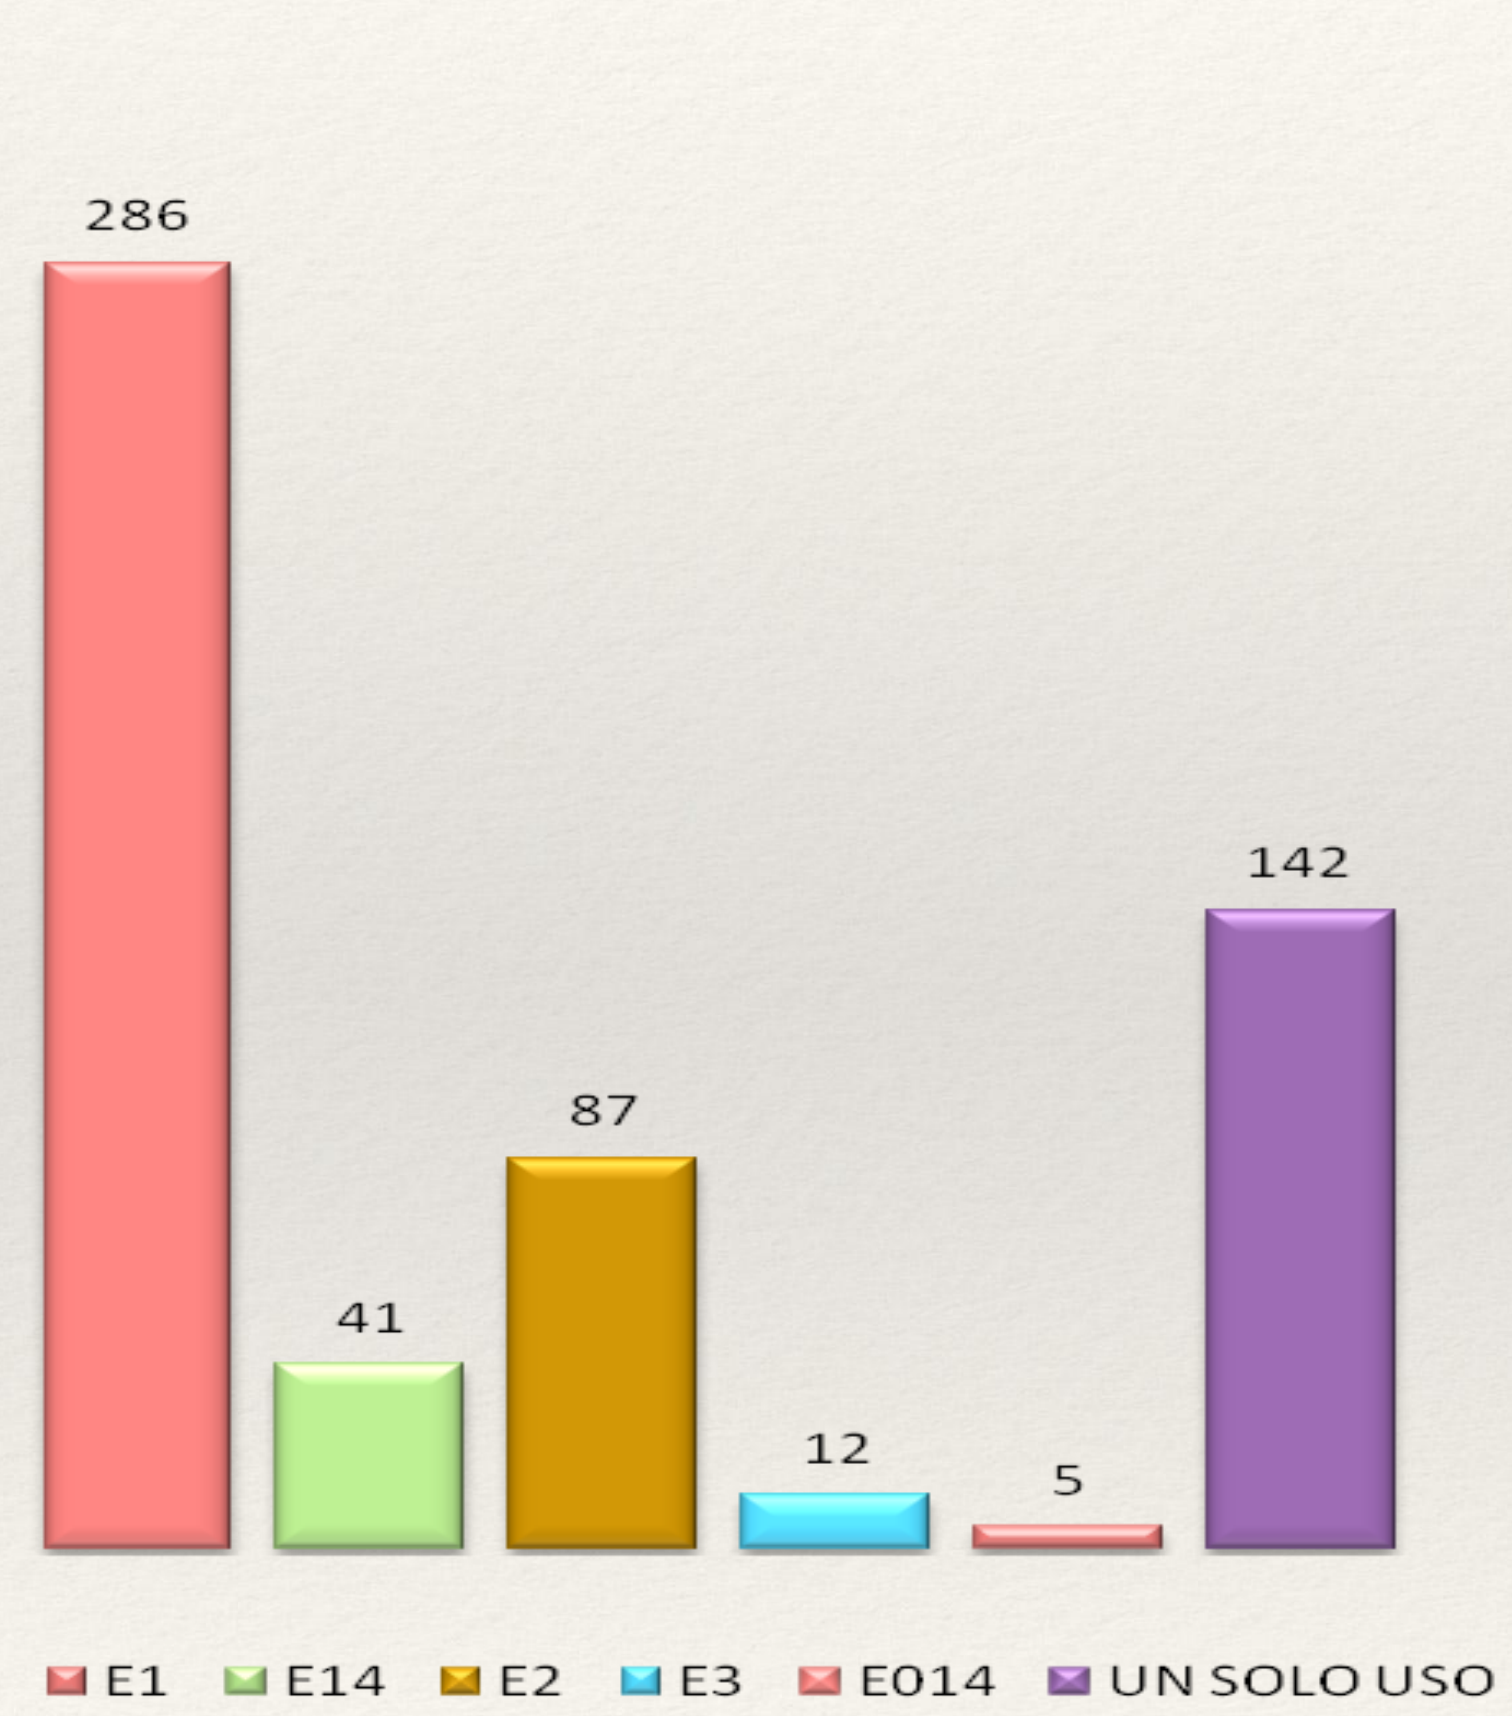

- E1** Material sucio
- E2** Material mojado
- E3** Material mal preparado
- E14** Material oxidado
- E014** Material punzante
- Single use Only** Material un solo uso

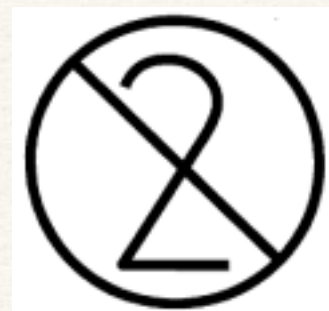

Material de un solo uso

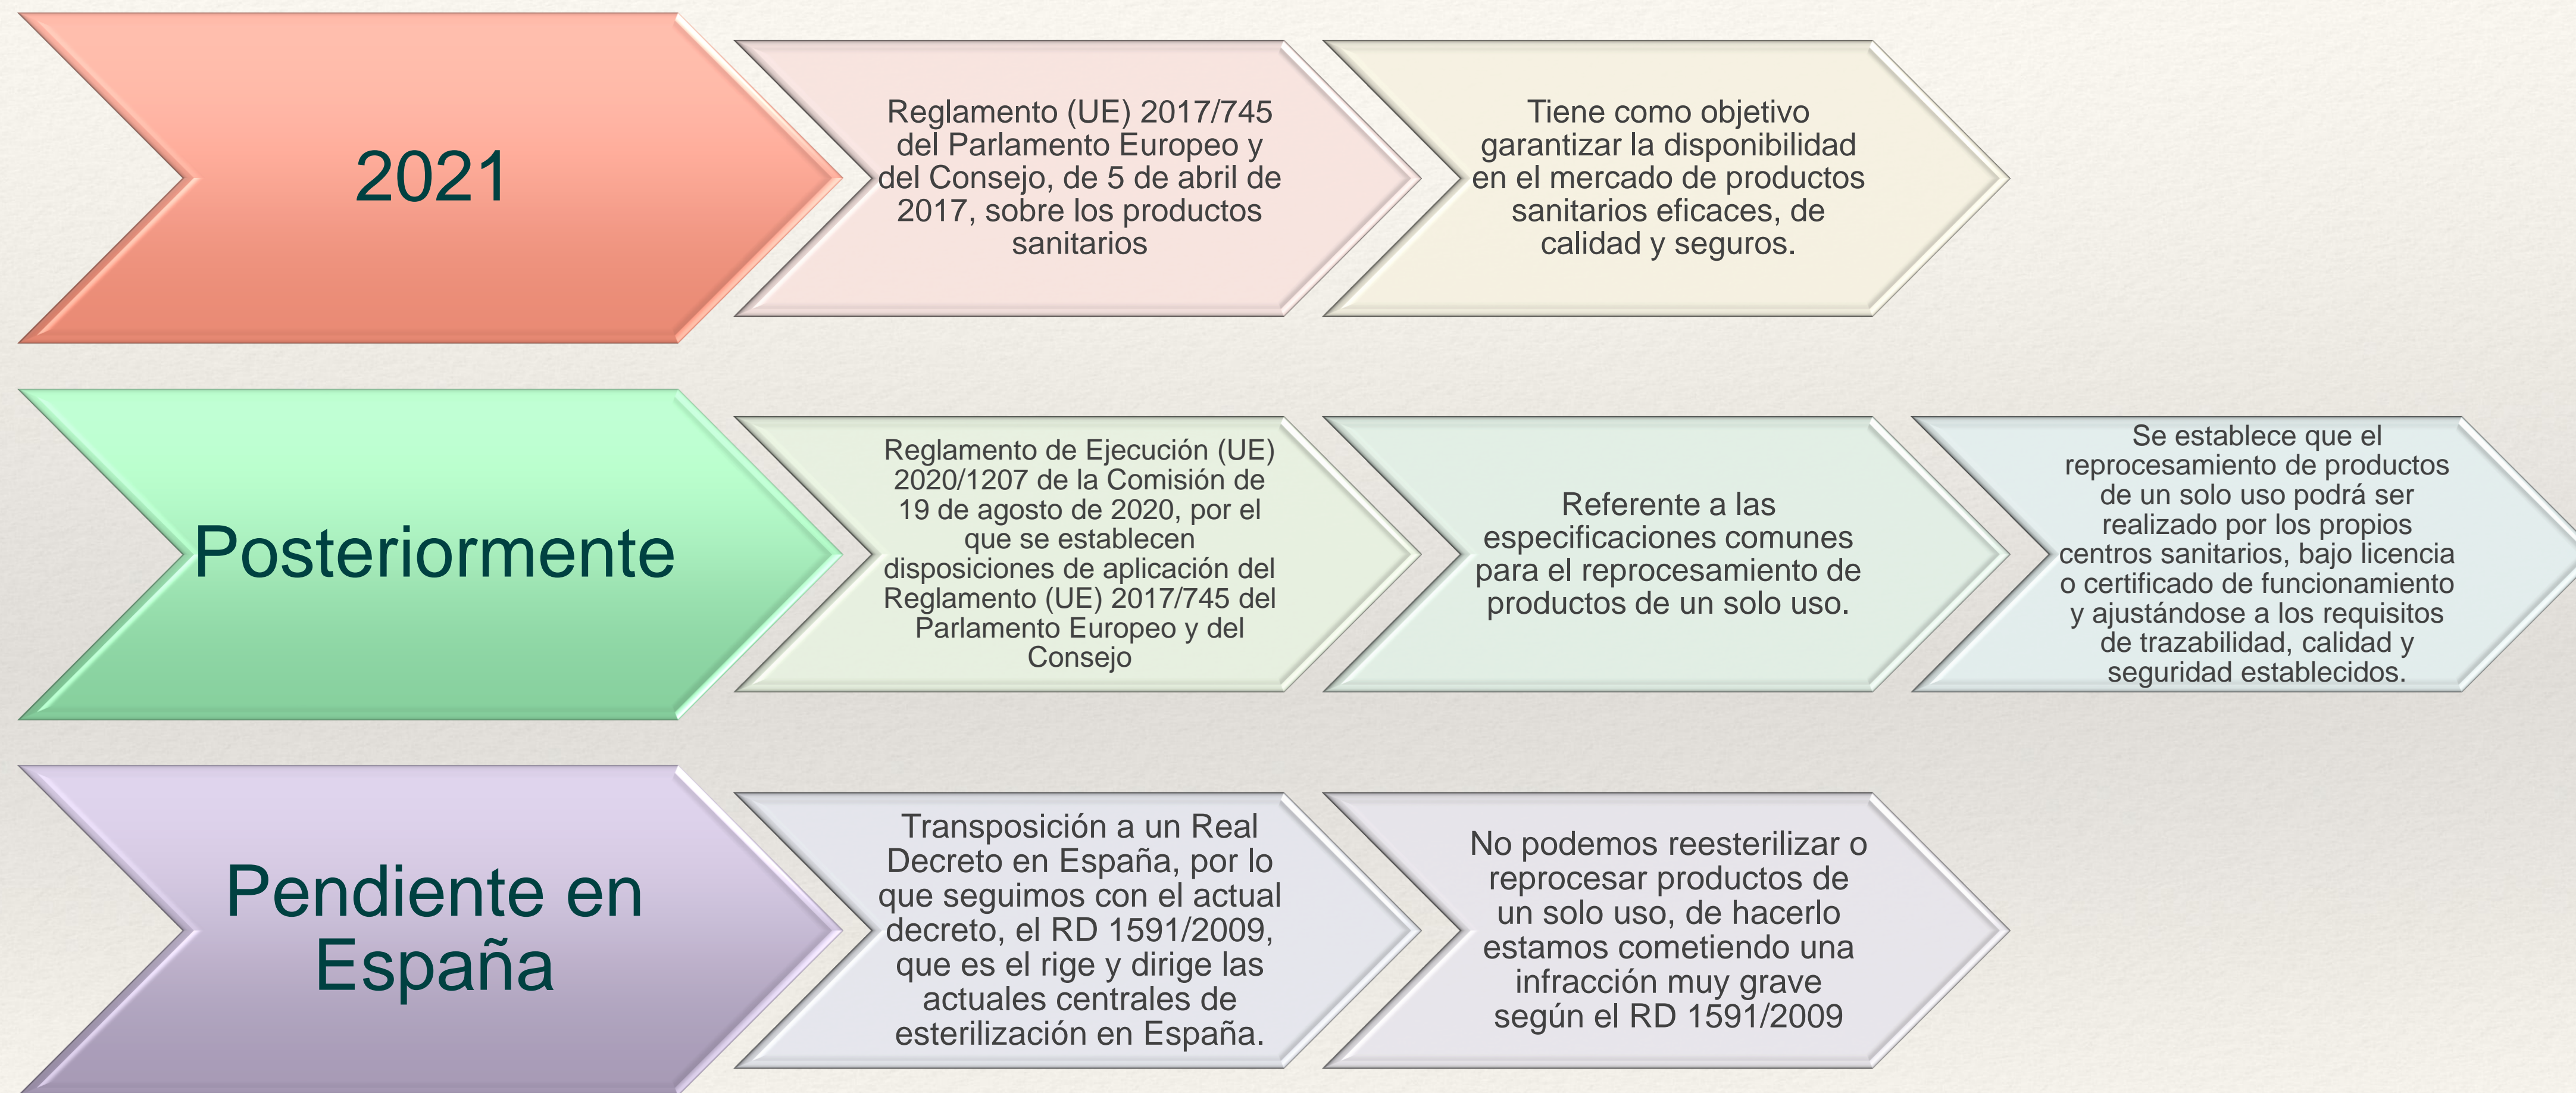



GRACIAS!!