

DEL POUPINEL AL AUTOCLAVE

HISTÓRIA DE LA CREACIÓ DE UNA CENTRAL DE ESTERILIZACIÓ EN EL HOSPITAL SAINT JEAN DE DIEU DE THIÈS (SENEGAL)

M. Loureiro, G. Comallonga, R. Alsedà
Grup de Cooperació - Fundació Althaia de Manresa
Jornadas de Esterilización 2017 – COIB
9 y 10 de octubre de 2017

INTRODUCCIÓN

PROGRAMA DE COOPERACIÓN

Hôpital Saint Jean de Dieu de
Thiès (Sénégal)



Fundació Althaia
Xarxa Assistencial Universitària
de Manresa (Catalunya)





ÁMBITO DE ESTUDIO

SENEGAL (2017)	
Población	15 millones habitantes
Tasa natalidad 	37,20 ‰
Tasa mortalidad	7,70 ‰
Tasa mortalidad menores 5 años	54 ‰
Esperanza de vida al nacer	64,8 años
Índice crecimiento	2,42 %
Índice Desarrollo Humano	0,470 – 143/175 países

Fuente: ANSD Agence Nationale de la Statistique et de la Démographie [Internet]. Dakar: 7ANSD; 2008 [actualizado 19 febrero de 2017; citado 19 de febrero de 2017]. Disponible en <http://www.ansd.sn>

Datos (2016)

Servicios

- Hospitalización (125 camas)
- Urgencias (24 horas)
- Bloque quirúrgico (3 quirófanos)
- Unidad curas intensivas
- Consultas externas
- Laboratorio
- Radiología...

Especialidades

- Medicina interna (+ especialidades)
- Cirugía y urología
- Traumatología y ortopedia
- Maternidad, obstetricia y pediatría
- Neurocirugía, oftalmología, otorrinolaringología...

Personal

122 profesionales


Datos

(número pacientes)

- Consultas externas: 37854
- Urgencias: 5594
- Hospitalización: 4405
- Intervenciones quirúrgicas: 1153



SITUACIÓN INICIAL

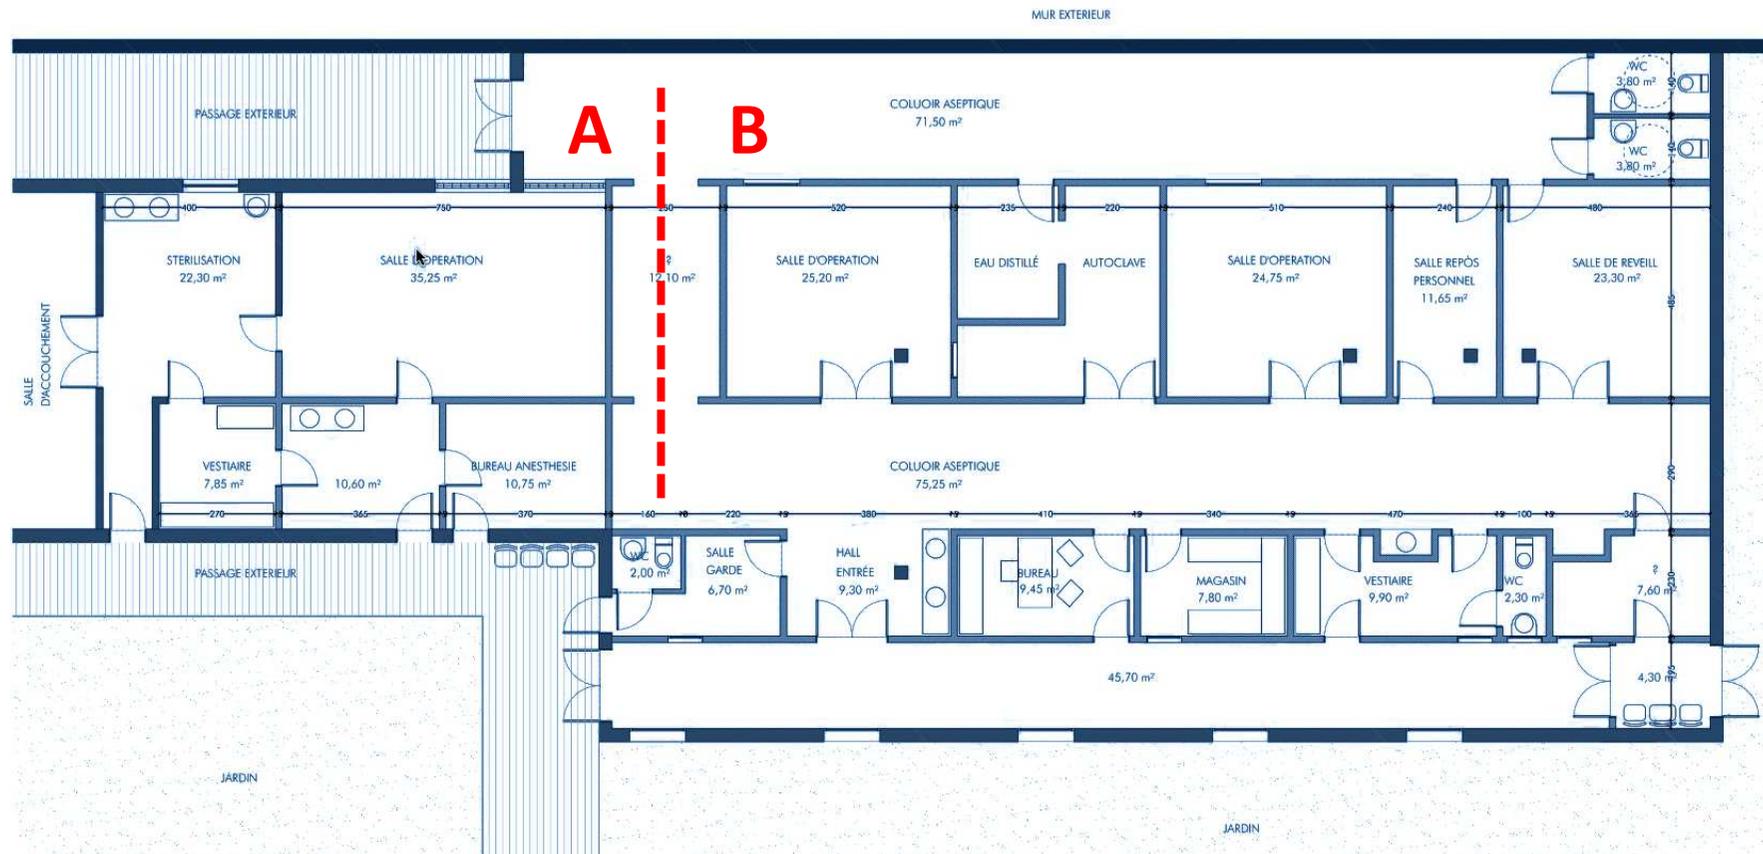





SALLE DE REVEIL 23,30 m²
 SALLE REPÓS PERSONNEL 11,65 m²
 SALLE D'OPERATION 24,75 m²




EAU DISTILLÉ
 SALLE D'OPERATION 25,20 m²
 12 m²
 SALLE D'OPERATION 35,25 m²

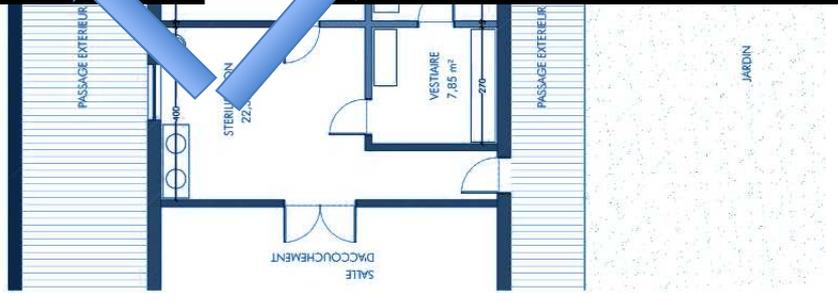

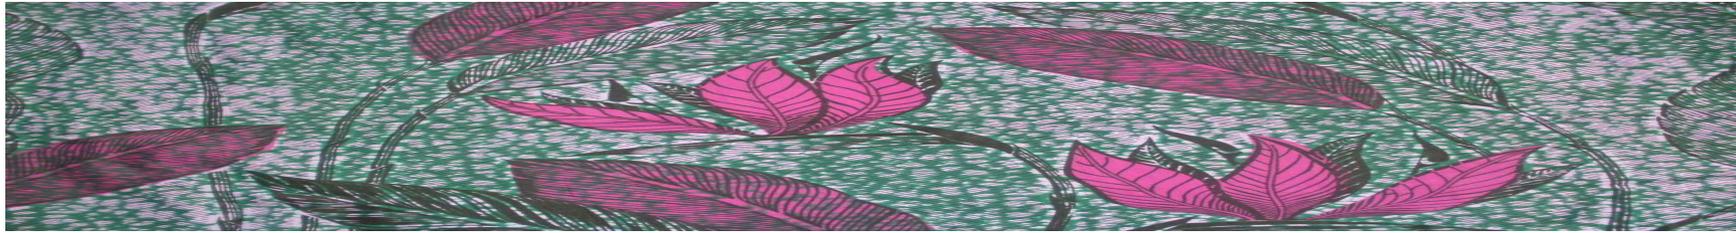

- Poupinels y autoclaves descatalogados.



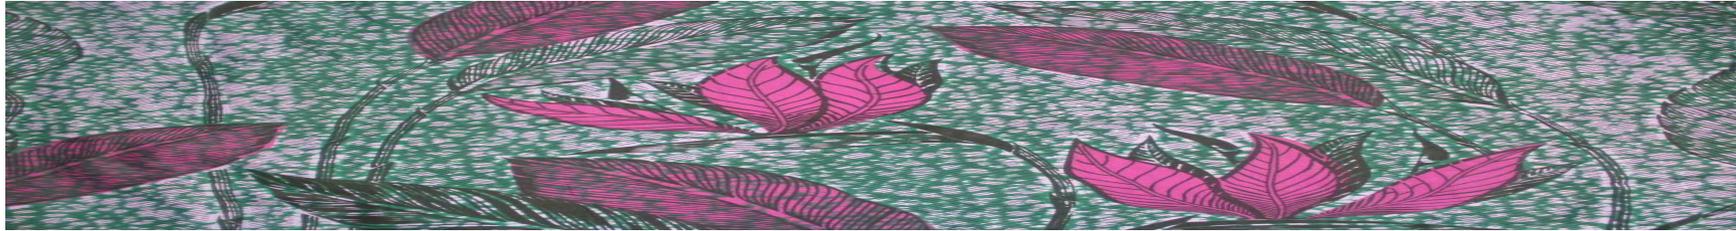


- Material quirúrgico viejo y en mal estado.





- No hay ningún sistema de control de los procesos de esterilización.



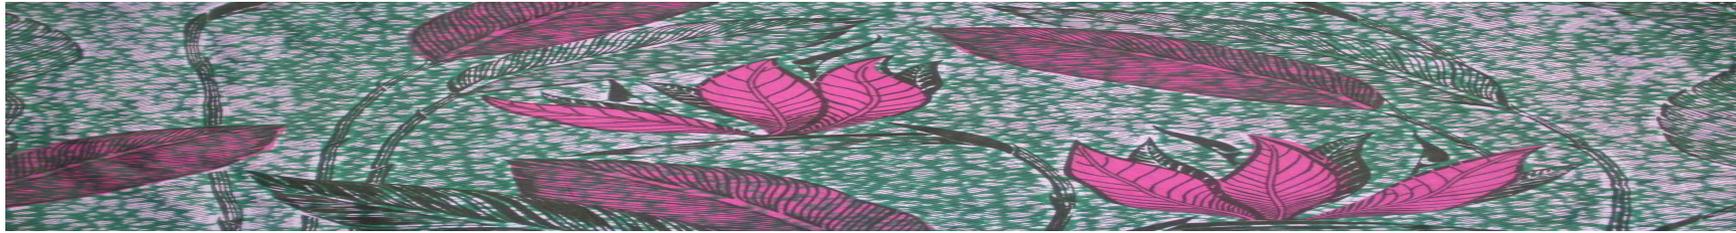

- Personal de quirófano y mantenimiento poco formado.



OBJETIVOS


1. Crear una central de esterilización capaz de responder a las necesidades de todos los servicios del hospital.
2. Formar, asesorar y capacitar al personal en todos los procesos del servicio de esterilización.
3. Elaborar normas de funcionamiento de la central, manuales de procedimiento y controles de esterilización.

MATERIAL Y METÓDO

PROYECTO DE LA CENTRAL DE ESTERILIZACIÓN ALTHAIA – THIÈS:

1. Planificar y construir una central de esterilización.
2. Actualizar equipos.
3. Formar personal sanitario y de mantenimiento.
4. Crear protocolos y guías de trabajo.
5. Puesta en marcha del servicio.




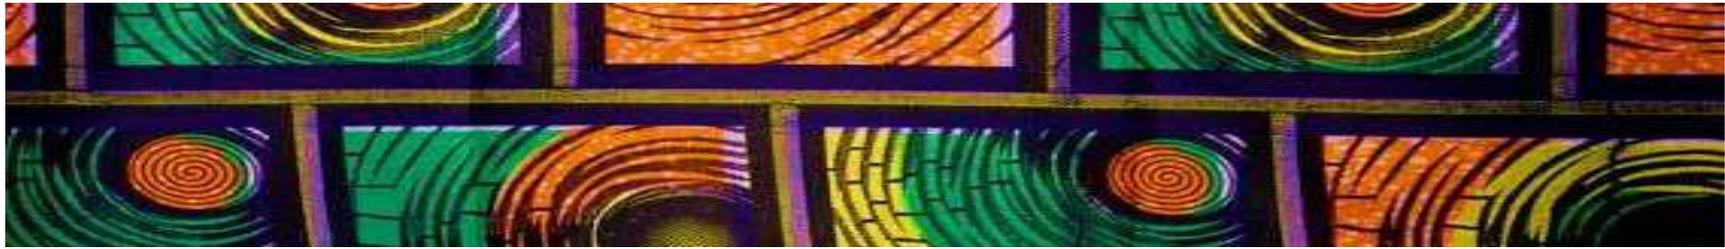


2. Equipar la nueva central de esterilización: material quirúrgico, autoclaves y otro mobiliario.





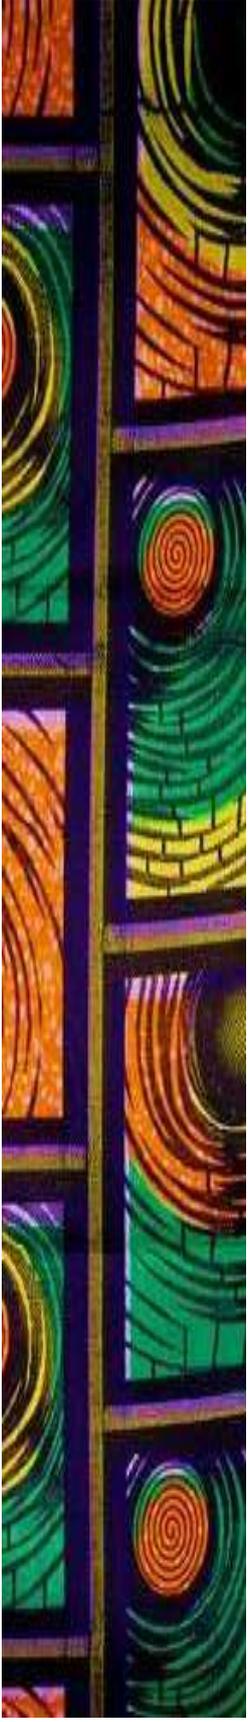

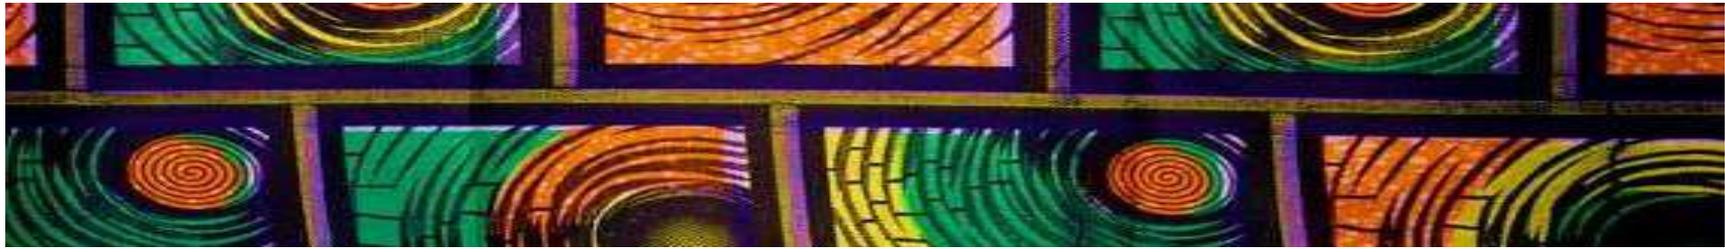

3. Formación de una enfermera responsable de la central de esterilización, formadora del resto de personal quirúrgico, y del personal de mantenimiento.





4. Realización de protocolos y guías de trabajo.



Chirurgie générale

Boîte de hernie x 2

Manquant	Nombre	Instruments
	1	Manche de bistouri n° 4 court
	2	Pince avec griffes 18 cm
	2	Pince sans griffes 18 cm
	1	Ciseau à fil
	1	Ciseau à disséquer Metzenbaum
	6	Pinces Kocher 18 cm
	2	Pinces Foerster courtes
	2	Pinces Allis 19 cm
	6	Pinces à hémostase Kelly
	2	Pinces à hémostase Mosquito
	2	Dissecteurs 19 cm
	2	Porte-aiguilles
	2	Ecarteurs de Faraboeuf L
	6	Pinces à champ
	1	Pince à désinfecter
	2	Cupules

CONCLUSIONES

EFICIENCIA, EFICÁCIA Y SEGURIDAD





MOLTES GRÀCIES!



**XARXA ASSISTENCIAL
UNIVERSITÀRIA DE MANRESA**

Dr. Joan Soler, 1-3
08243 Manresa

Tel. 93 875 93 00
Fax 93 873 62 04

althaia@althaia.cat
www.althaia.cat